


Laboratorium badań



Legenda

- 0 KLIMATYZATOR
- 1 STÓŁ
- 2 FLEKSOMETR BALLY'EGO
- 3 TESTER ŚCIERALNOŚCI - MARTINDALE 2000
- 4 TESTER ŚCIERALNOŚCI - SCHOPPER-SCHLOBACH
- 5 INSTRON
- 6 APARATURA DO BADANIA ZGINANIA PODESZWY
- 7 CHROMATOGRAF GAZOWY Z DETEKTOREM MASOWYM
- 8 MIKROSKOP
- 9 URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI ELEMENTÓW W SKÓRZE
- 10 CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM DIODOWYM
- 11 URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW W SKÓRACH
- 12 SPEKTROFOTOMETR UV/VIS
- 13 MIEJSCE DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK

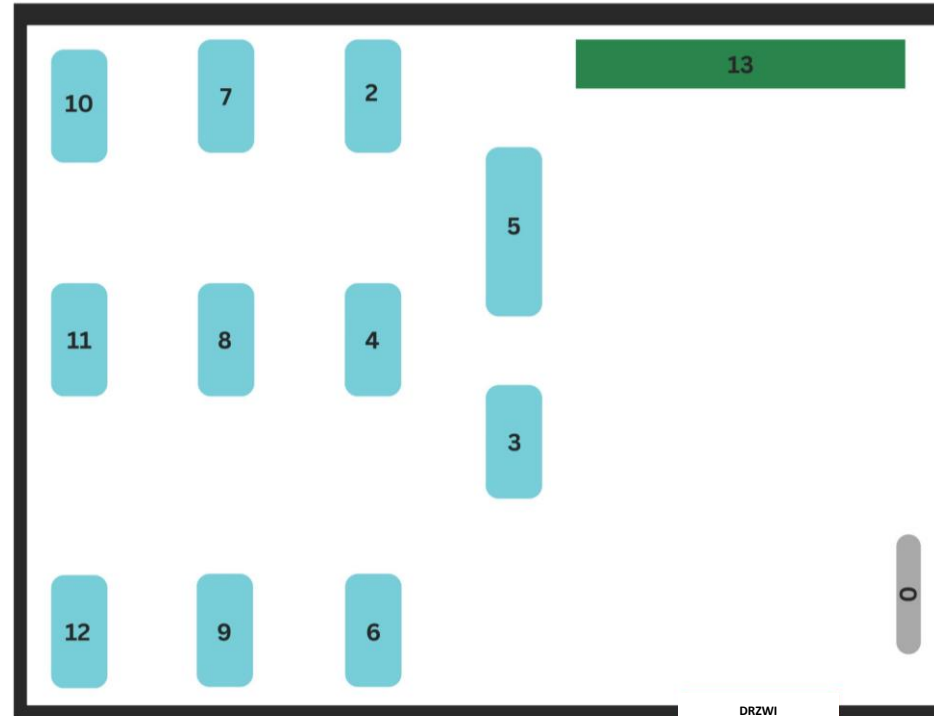

Legenda

- 0 KLIMATYZATOR
- 1 STÓŁ
- 2 PENETROMETR BALLY'EGO
- 3 APARATURA DO BADANIA PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ I WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ/WDA
- 4 MIEJSCE DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK

Hygienic laboratory

