


Laboratório de Ensaios



Subtítulos

- 0 - Sistema de climatização
- 1 - Mesa
- 2 - Flexómetro Bally
- 3 - Teste de abrasão Martindale 2000
- 4 - Teste de abrasão Schopper-Schlobach
- 5 - Dinamômetro Instron
- 6 - Flexómetro de solas
- 7 - Cromatógrafo de gases com detetor de massa
- 8 - Microscópio
- 9 - FTIR (Infravermelho por Transformada Inversa de Fourier)
- 10 - DaD (Cromatógrafo de líquidos por Diodo)
- 11 - FTIR (Infravermelho por Transformada Inversa de Fourier)
- 12 - Espectrofotômetro UV/VIS
- 13 - Espaço para preparação das amostras

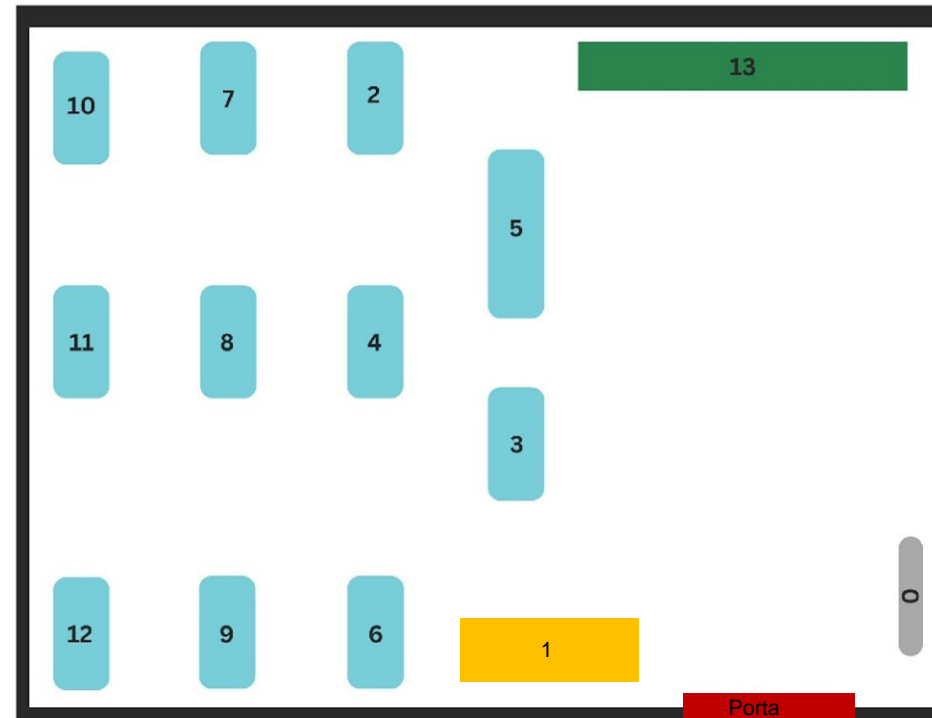

Subtítulos

- 0 - Sistema de climatização
- 1 - Mesa
- 2 - Penetrômetro Bally
- 3 - Permeabilidade ao vapor de água e fator de permeabilidade ao vapor de água (PVA e CVA)
- 4 - Espaço para preparação das amostras

Laboratório Químico com condições higiénicas

